
PROMAIZ

CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA DE ESTUFAS

Código	
Revisión	
Fecha	
Página	
Revisado por	
Aprobado por	

N°Estufa :	PML-034
Termometro utilizado:	PMQ-EGF-01
FC (°C)	
Corrección en lecturas diarias (°C):	

MES DE CONTROL:	DICIEMBRE
AÑO:	2016

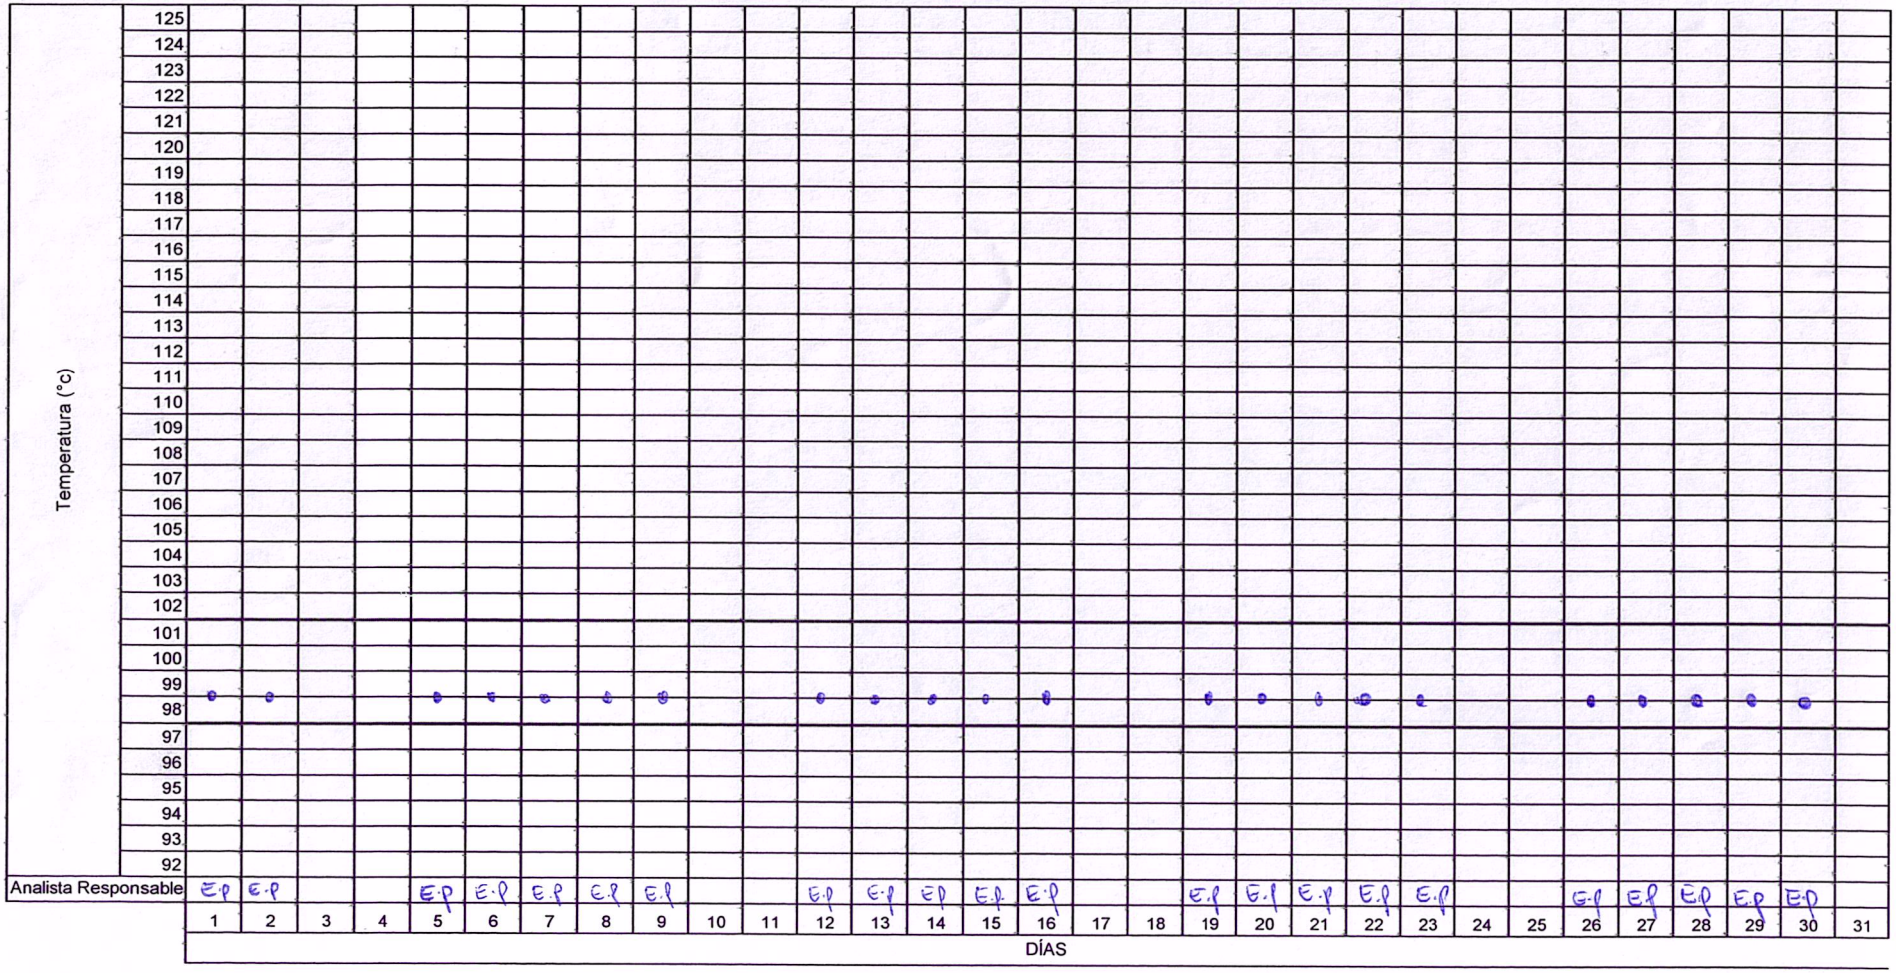

OBSERVACIONES:_____

_____

FC = Factor de corrección (indicar como sumar x °C o restar x °C)

SI DETECTA ALGUN VALOR FUERA DE LOS LIMITES DE CONTROL DAR AVISO DE INMEDIATO A SU JEFE.

V° B JEFE DE LABORATORIO