
PROMAIZ

# CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA DE ESTUFAS

| | |
|---|---|
| Código | |
| Revisión | |
| Fecha | |
| Página | |
| Revisado por | |
| Aprobado por | |

| | |
|---|---|
| **N°Estufa :** | PML-031 |
| **Termometro utilizado:** | PMQ-EV-04 |
| **FC (°C)** | |
| **Corrección en lecturas diarias (°C):** | |

| | |
|---|---|
| **MES DE CONTROL:** | JUNIO |
| **AÑO:** | 2017 |

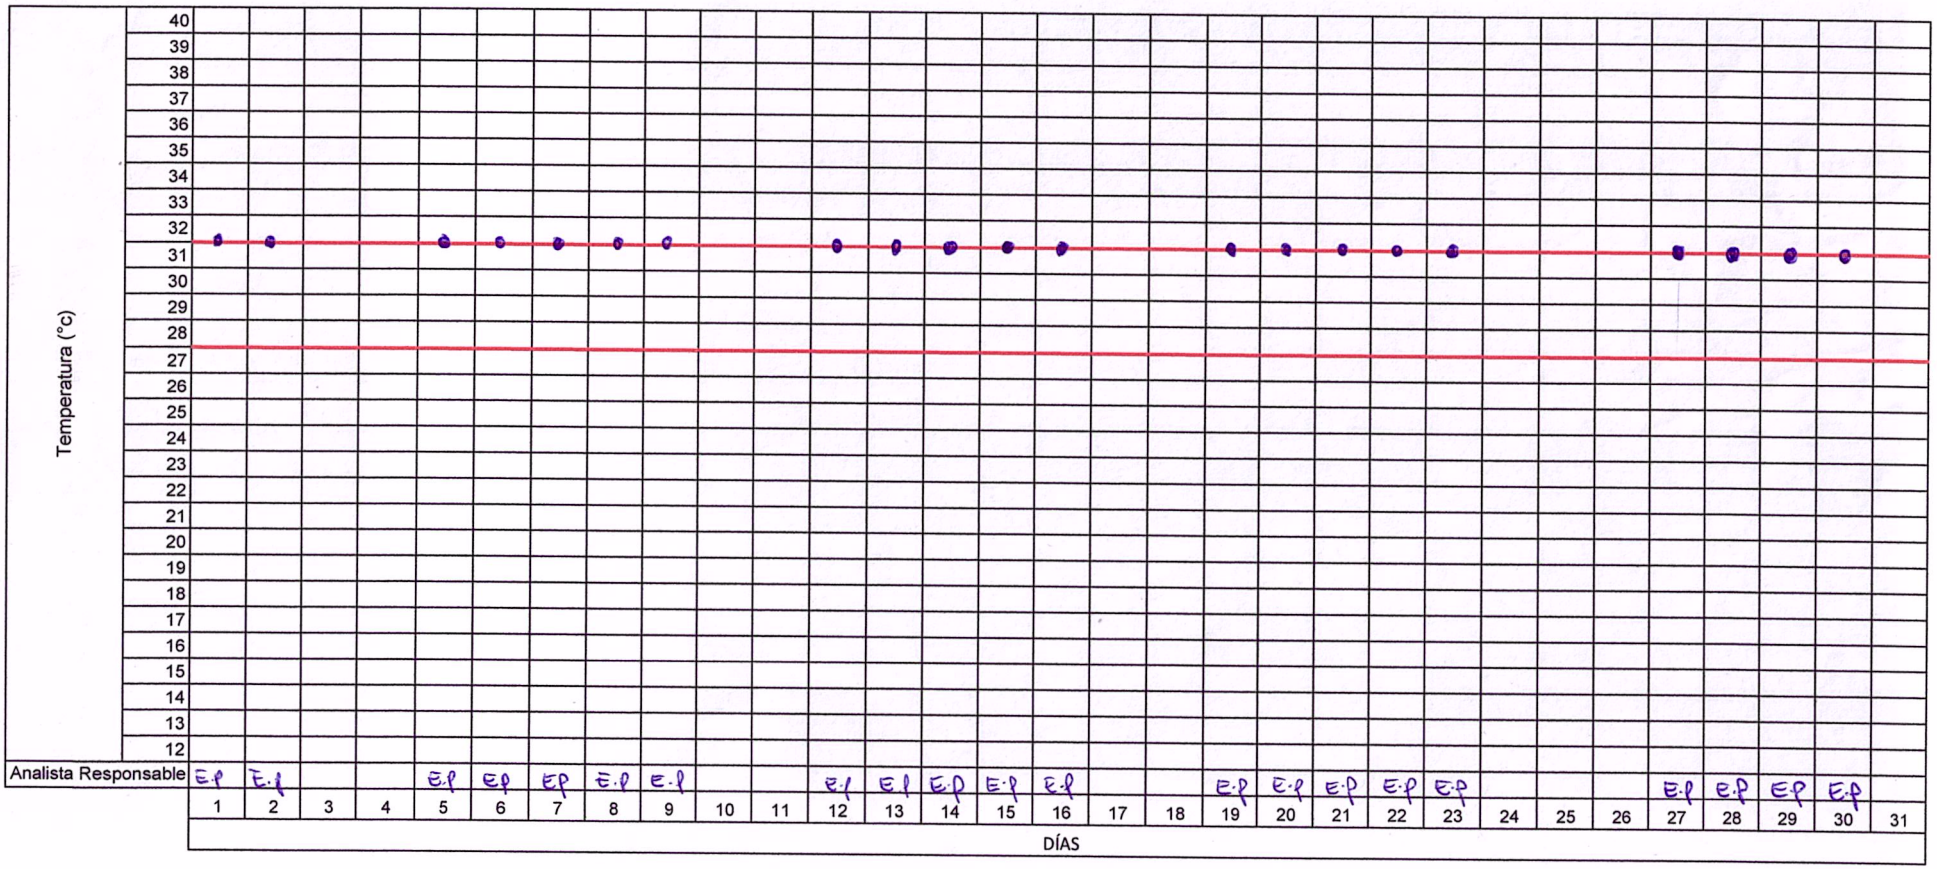


OBSERVACIONES:_____

FC = Factor de corrección (indicar como sumar x °C o restar x °C)

**SI DETECTA ALGUN VALOR FUERA DE LOS LIMITES DE CONTROL DAR AVISO DE INMEDIATO A SU JEFE.**

**V° B JEFE DE LABORATORIO**