
| PROMAIZ | CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA DE ESTUFAS | Código | |
|---|---|---|---|
| | | Revisión | |
| | | Fecha | |
| | | Página | |
| | | Revisado por | |
| | | Aprobado por | |

| | |
|---|---|
| **N°Estufa :** | PML-035 |
| **Termometro utilizado:** | PMQ-EGF-02 |
| **FC (°C)** | |
| **Corrección en lecturas diarias (°C):** | |

| | |
|---|---|
| **MES DE CONTROL:** | JULIO |
| **AÑO:** | 2017 |

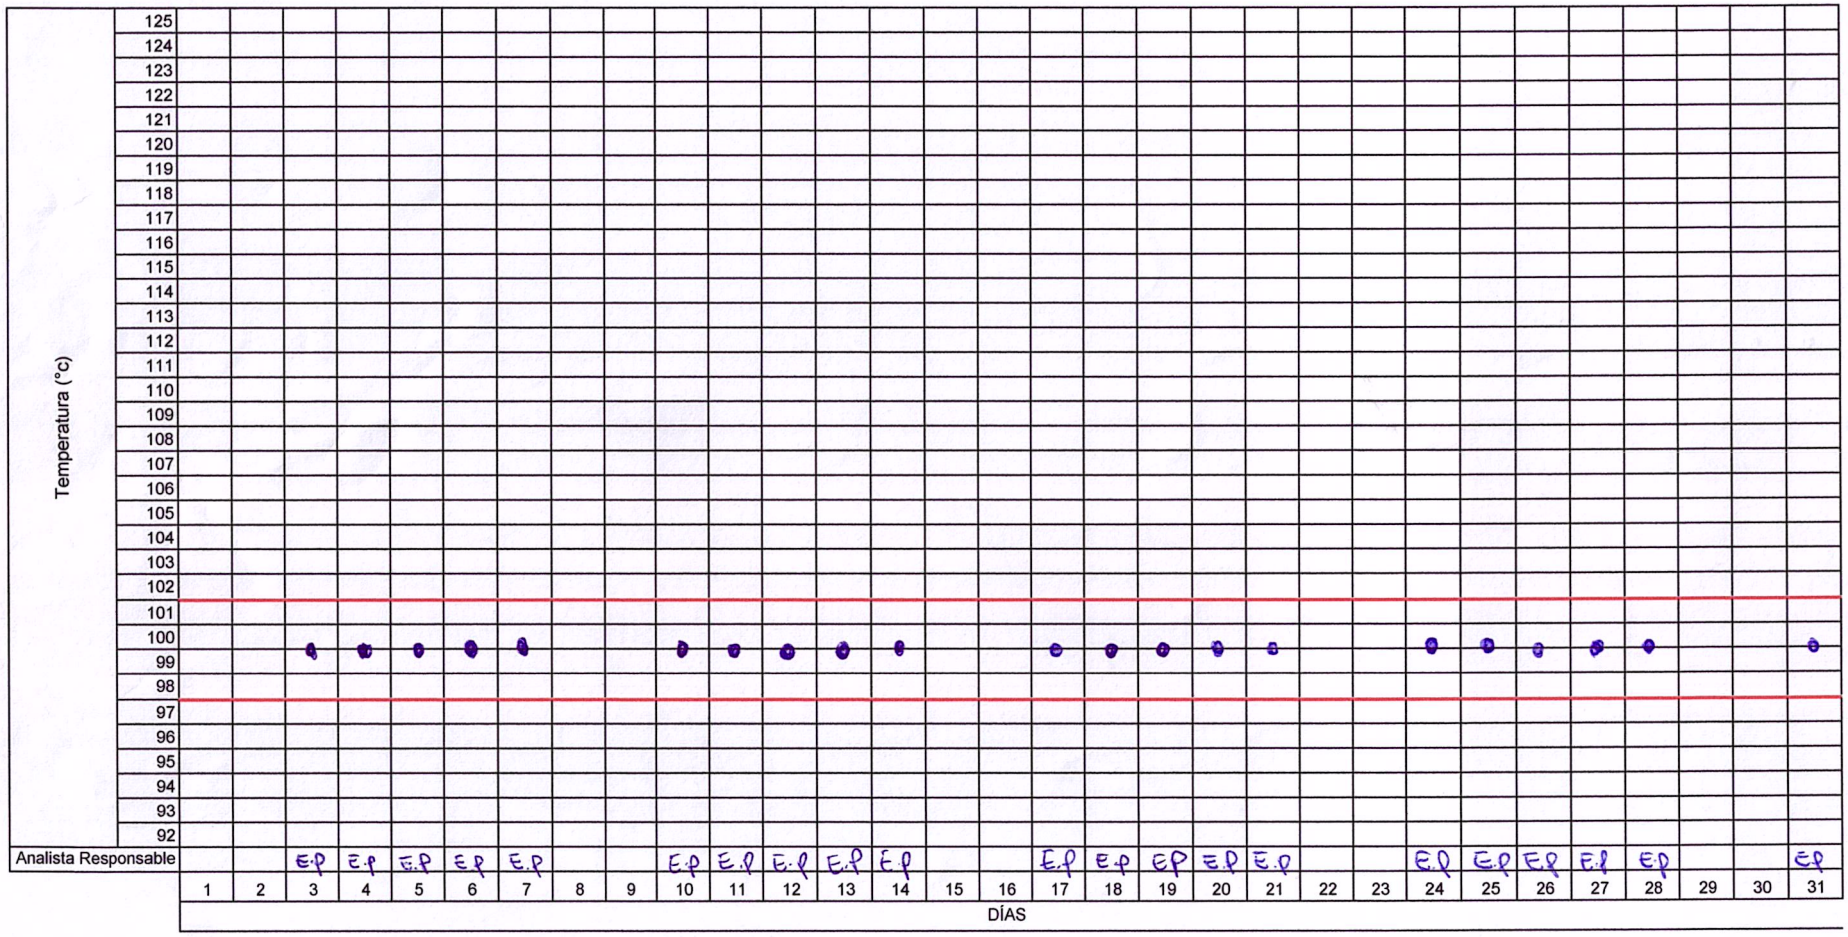


OBSERVACIONES:_____

FC = Factor de corrección (indicar como sumar x °C o restar x °C)

**SI DETECTA ALGUN VALOR FUERA DE LOS LIMITES DE CONTROL DAR AVISO DE INMEDIATO A SU JEFE.**

**V° B JEFE DE LABORATORIO**