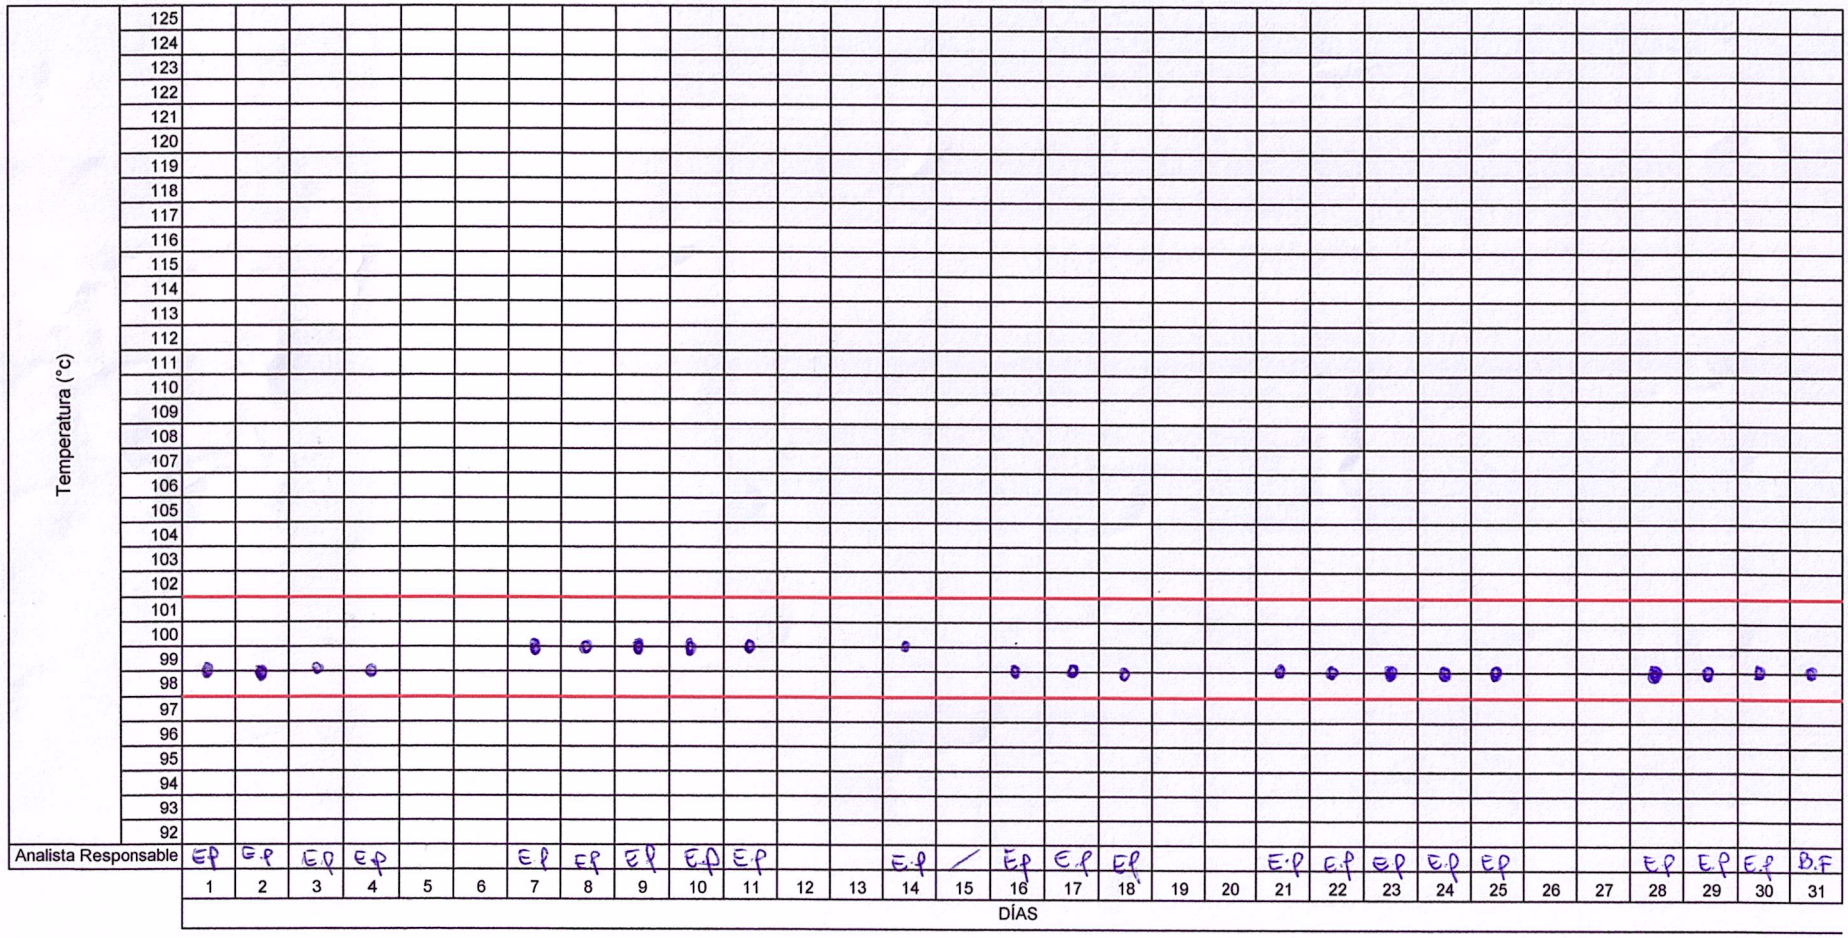
PROMAIZ

CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA DE ESTUFAS

Código	
Revisión	
Fecha	
Página	
Revisado por	
Aprobado por	

N°Estufa :	PML-035
Termometro utilizado:	PMQ-EGF-02
FC (°C)	
Corrección en lecturas diarias (°C):	

MES DE CONTROL:	AGOSTO
AÑO:	2017


Temperatura (°c)
125
124
123
122
121
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
Analista Responsable
EP E.P EP EP E P EP E P E.P E.P E.P E.P E P E P E.P E.P E P E P E