
PROMAIZ

CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA DE ESTUFAS

Código	
Revisión	
Fecha	
Página	
Revisado por	
Aprobado por	

N°Estufa :	PML-031
Termometro utilizado:	PMQ-EV-04
FC (°C)	
Corrección en lecturas diarias (°C):	

MES DE CONTROL:	NOVIEMBRE
AÑO:	2016

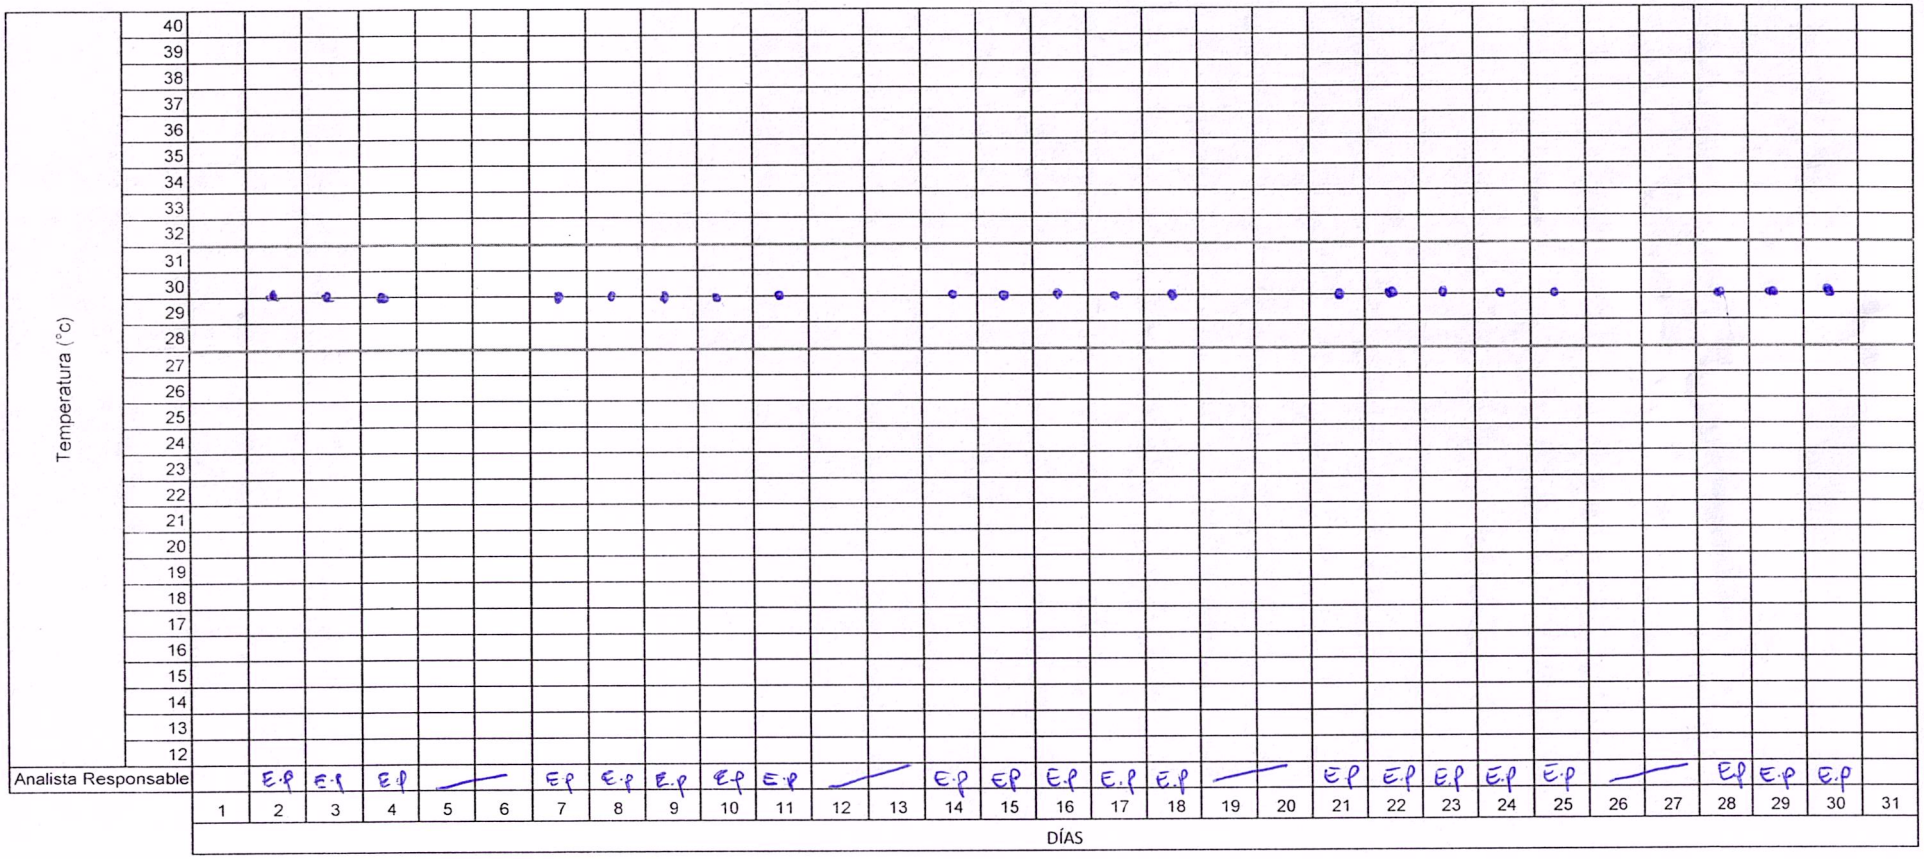

OBSERVACIONES:_____

_____

FC = Factor de corrección (indicar como sumar x °C o restar x °C)

SI DETECTA ALGUN VALOR FUERA DE LOS LIMITES DE CONTROL DAR AVISO DE INMEDIATO A SU JEFE.

_____

V° B JEFE DE LABORATORIO