
| PROMAIZ | CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA DE ESTUFAS | Código | |
|---|---|---|---|
| | | Revisión | |
| | | Fecha | |
| | | Página | |
| | | Revisado por | |
| | | Aprobado por | |

| | |
|---|---|
| N°Estufa : | PML-033 |
| Termometro utilizado: | PMQ-EA-01 |
| FC (°C) | |
| Corrección en lecturas diarias (°C): | |

| | |
|---|---|
| MES DE CONTROL: | NOVIEMBRE |
| AÑO: | 2016 |

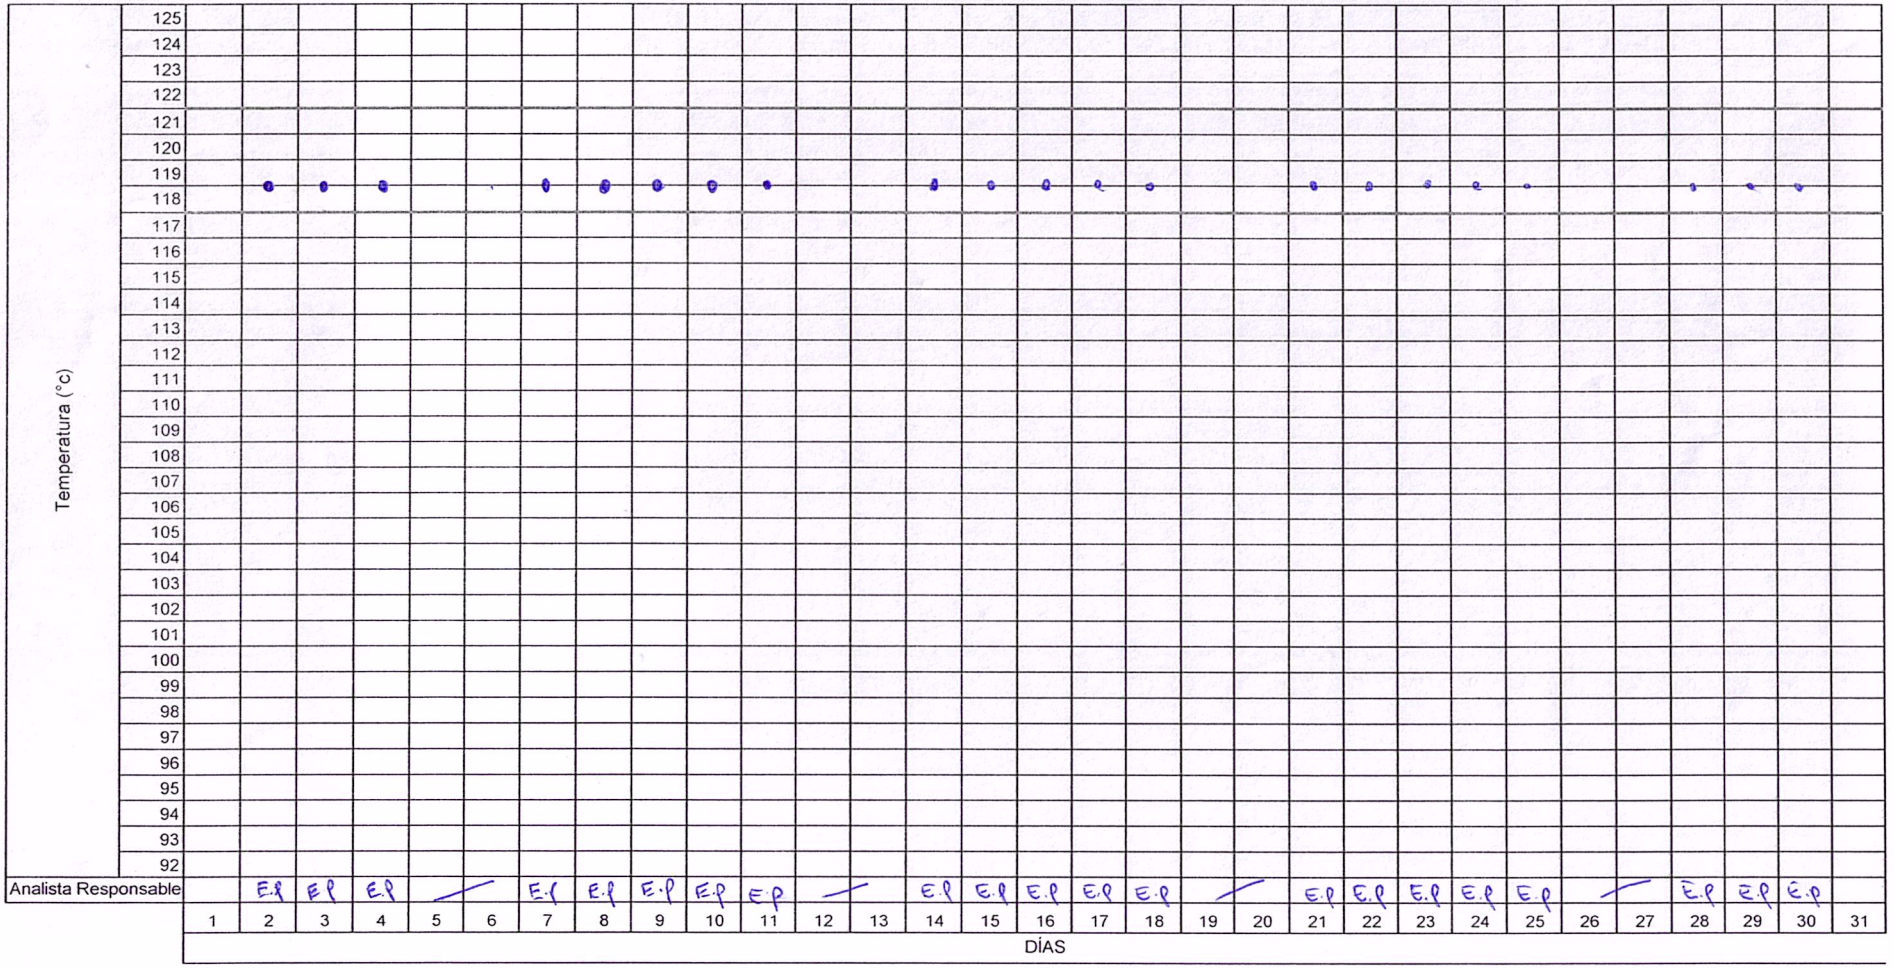


OBSERVACIONES:_____

FC = Factor de corrección (indicar como sumar x °C o restar x °C)

**SI DETECTA ALGUN VALOR FUERA DE LOS LIMITES DE CONTROL DAR AVISO DE INMEDIATO A SU JEFE.**

**V° B JEFE DE LABORATORIO**