
PROMAIZ	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA DE ESTUFAS	Código	
		Revisión	
		Fecha	
		Página	
		Revisado por	
		Aprobado por	

N°Estufa :	PML-035
Termometro utilizado:	PMQ-EGF-02
FC (°C)	
Corrección en lecturas diarias (°C):	

MES DE CONTROL:	NOVIEMBRE
AÑO:	2016

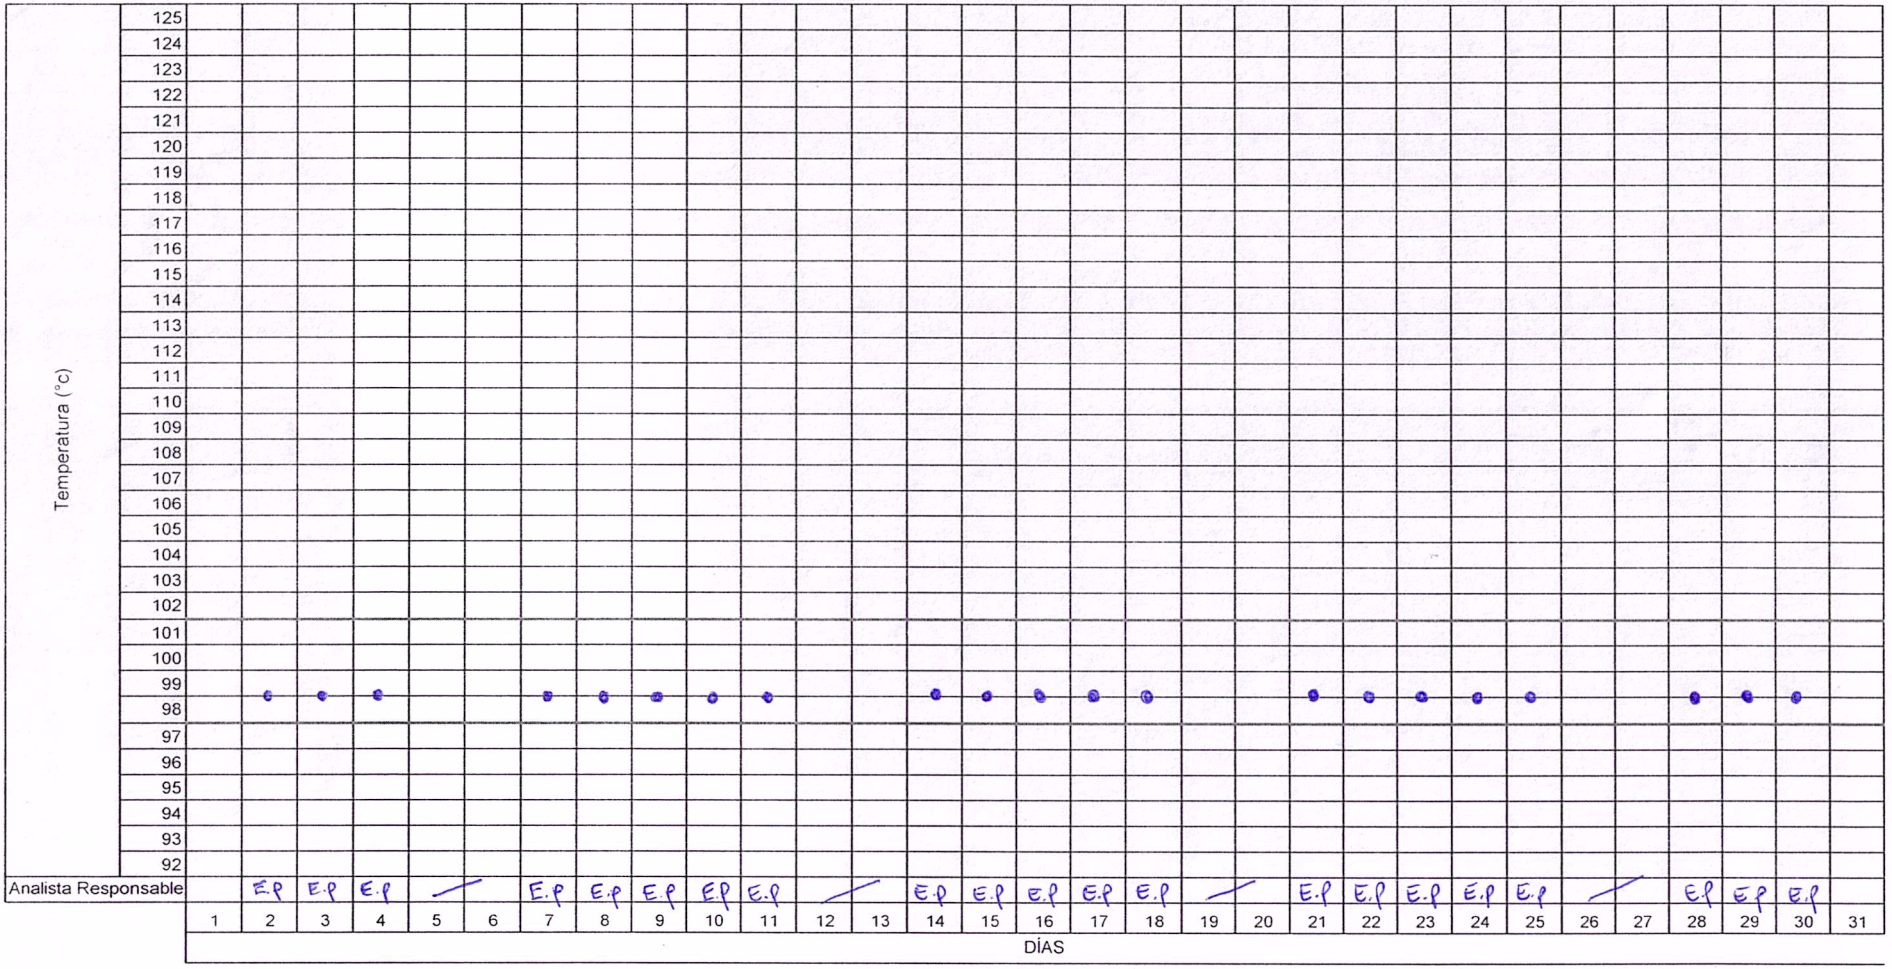

OBSERVACIONES:_____

FC = Factor de corrección (indicar como sumar x °C o restar x °C)

SI DETECTA ALGUN VALOR FUERA DE LOS LIMITES DE CONTROL DAR AVISO DE INMEDIATO A SU JEFE.

V° B JEFE DE LABORATORIO